

機械器具 3 医療用消毒器
 管理医療機器 液体用高压蒸気滅菌器 (JMDコード : 41450010)

特定保守管理医療機器 (設置) **サクラ薬液用高压蒸気滅菌装置** Y R - O - S L P

【警告】

- ・装置、被滅菌物は高温になるのでヤケドに注意する。
- ・圧力が異常上昇したら蒸気バルブを閉じる。
- ・滅菌室内に人がいないことを確認する。


【禁忌・禁止】

- ・大気圧以上で扉を開放しない。
- ・装置内に引火性、爆発性物質を入れて使用しない。
- ・液体、液体の容器、医療用器具以外の物は滅菌しない。
- ・人体に有毒な液体、腐食性のある液体は滅菌しない。
- ・液体入り容器を急冷したり衝撃を加えない。


【形状・構造及び原理等】

[本体]

本図は代表例です。仕様により実際の装置と異なる場合があります。

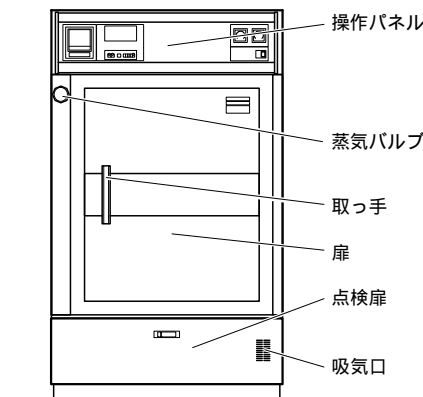


操作側

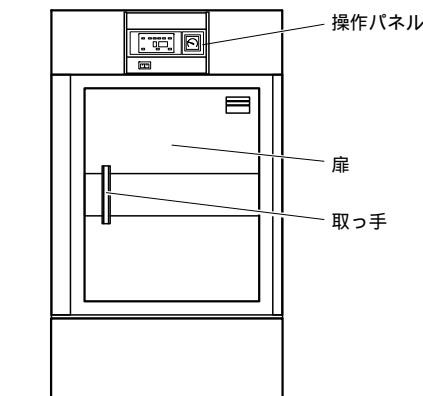

反操作側(両扉仕様の場合)

[操作パネル]

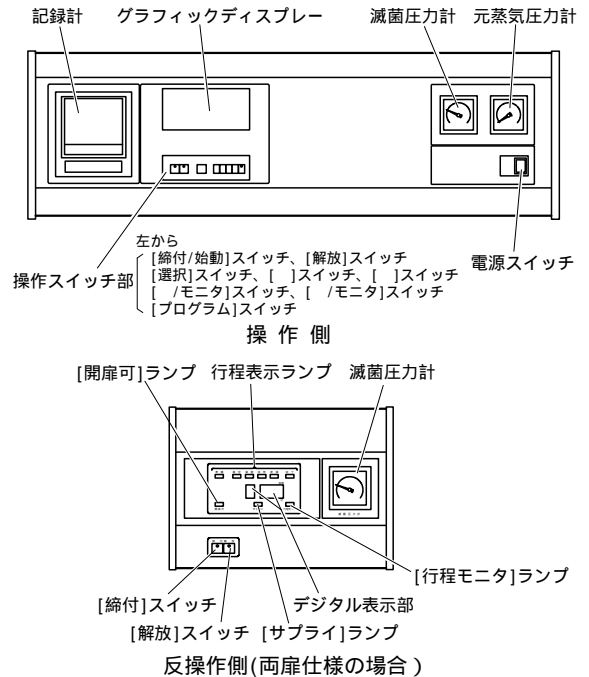

[必要とする設備]

** 電源設備

型 式	06・09(W)	12(W)
AC100V	1.5 A	
AC200V 50Hz 3 60Hz	10.5A以上	16.5A以上
接地端子	D種以上	

給蒸設備

型 式	06	09(W)・12(W)
圧 力	0.4 ~ 0.5 MPa	
容 量	80kg/h以上	120kg/h以上

給水設備 (容量は最小値)

型 式	06	09	09W	12	12W
圧 力	0.2 ~ 0.4 MPa				
容 量	35L/min	47L/min	49L/min	59L/min	61L/min
温 度	20 以下				

圧縮空気設備

圧 力	0.5 ~ 0.6 MPa
容 量	3.0L/min ANR 以上
温 度	40 以下

排気・排水設備

方 式	単独屋外排気・排水
配 管	SGP50A 以上

取扱説明書を必ずご参照ください。

[動作原理]

運転が開始されると、滅菌室内に蒸気が流通され、空気の排出とともに、被滅菌物が所定時間加温される。
次に、滅菌室内に蒸気を入れて滅菌を行う。所定時間が経過すると、滅菌室内の蒸気を徐々に外部に排出（低速排気）する。その後、設定時間が経過し、サンプル温度が冷却温度以下に低下するまで放置冷却を行う。所定温度になると運転が終了となり、ブザーと「開扉可」表示灯で報知する。
異常が発生すると、装置はより安全な状態に移る動作をするとともに、警報表示とブザーで使用者に報知する。

***【使用目的、効能又は効果】**

微生物を不活性化する滅菌剤として湿熱(通常、蒸気)を利用し、密閉容器中の液体を滅菌するために用いる装置をいう。

***【品目仕様等】**

項目	仕様
最高使用圧力	0.20 MPa
行程ミタリゲ制御装置	温度表示：0～160 精度±2 圧力表示：-100～300kPa 精度±13kPa アナログ式記録計：内筒温度、内筒圧力、運転日時デジタル記録
滅菌温度制御	110～125、70～121 設定範囲はプログラムにより異なる
滅菌タイマ	滅菌温度毎の最低設定時間～99分 1分毎に設定可能 積算式による滅菌タイマ減算制御
エアフィルタ	0.3µmの微粒子を99.97%以上除去

【操作方法又は使用方法等】

以下の手順の詳細は取扱説明書の第4章をご参照ください。

操作側の扉を開き、滅菌室内、排気ストレーナー及び扉パッキンに、傷や汚れがないことを確認する。
電源スイッチを「入」にする。
蒸気バルブを開く。
滅菌プログラムを選択し、被滅菌物を入れる。
サンプルボトルをセットする。(「空ビン滅菌」は不要)
扉を締め付ける。
記録紙の残量を点検し、「始動可」状態を確認してから【締付/始動】スイッチを押す。

運転が開始されます。運転が完了すると、ブザーと画面表示(反操作側はランプ)でお知らせします。

以降は、片扉仕様と両扉仕様の場合に分けて記述します。

《片扉仕様の場合》

記録紙で、正常終了であることを確認する。
画面に「開扉可」が表示され、滅菌圧力計が「0」であることを確認する。
扉を開き、被滅菌物を取り出す。
サンプルボトル内の液体温度を確認し、液温が低下したら廃棄する。(「空ビン滅菌」は不要)
蒸気バルブを閉じる。
電源スイッチを「切」にする。
扉を閉じる。(締め付けない)

《両扉仕様の場合》

記録紙で、正常終了であることを確認する。
反操作側の[開扉可]ランプが点灯し、滅菌圧力計が「0」であることを確認する。
反操作側の扉を開き、被滅菌物を取り出す。
反操作側の扉パッキンにゴミや傷がないことを確認し、扉を締め付ける。
操作側の扉を解放する。
サンプルボトル内の液体温度を確認し、液温が低下したら廃棄する。(「空ビン滅菌」は不要)
蒸気バルブを閉じる。
電源スイッチを「切」にする。
操作側の扉を閉じる。(締め付けない)

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書の第1章、第2章をご参照ください。

- ・薬液や洗剤の付着した物は滅菌しない。
- ・サビ、ゴミ、油脂等を含まない蒸気、水、圧縮空気を供給する。
- ・ドレーンの少ない蒸気を供給する。
- ・バイオリジカルインジケータを用いて、必要な滅菌条件を決定する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

*** [使用環境]**

周囲温度：10～50
相対湿度：30～85%RH(結露しないこと)
気圧：95～106kPa

[耐用期間]

耐用期間：製造出荷後 10年

条件：取扱説明書及び添付文書に記載された取扱注意事項あるいは保守・点検に係る事項を順守し、定期的に日常点検・保守点検を実施すること。
点検結果により、下記に示す主要な構成部品や保守点検事項に記載された交換部品を必要に応じ交換すること。
保守部品として供給される主要な構成部品は下表の通り。

主要な構成部品名	使用耐用年数
真空ポンプ	5年
扉駆動用モーター	5年
制御基板	4年
記録計	5年

ここに記載した装置の耐用期間及び主要な構成部品の使用耐用年数は保証期間ではなく、上記の条件を満たした場合での平均的な年数となるため、使用環境、使用方法などにより異なります。

【保守・点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

詳細は取扱説明書の第7章をご参照ください。

- ・滅菌圧力計 運転ごとに、扉を開いた状態で滅菌圧力計の指示が「0」からズレていないことを確認する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・滅菌室内 1日に1回、水を含ませた布で滅菌室内を清掃した後、内壁を洗浄する。
- ・排気ストレーナ 1日に1回、滅菌室内のストレーナをタワシまたは歯ブラシで水洗いする。
- ・圧縮空気フィルター 1日に1回、水抜きを行う。
- ・棚板・枠車 1週間に1回、固く絞ったガーゼ等で棚板両面とフレーム部分の汚れを拭き取る。
- ・扉パッキン 1ヶ月に1回、扉パッキンをガーゼ等で清掃し、傷等がないか点検する。また、半年に1回、新品と交換する。
- ・吸気口フィルター 1ヶ月に1回、清掃済みのものと交換する。外したフィルターは水洗いする。
- ・定期自主検査 「ボイラー及び圧力容器安全規則」による点検を1ヶ月に1回行い、その記録を保管する。
- ・性能検査 「ボイラー及び圧力容器安全規則」による性能検査を1年に1回行う。

【業者による保守点検事項】

- ・給水ストレーナ 定期的、または警報が出たとき、給水配管にあるストレーナを清掃する。破損したり、目詰まりが除去できなくなったら新品と交換する。
- ・給蒸ストレーナ 定期的、または警報が出たとき、給蒸配管にあるストレーナを清掃する。破損したり、目詰まりが除去できなくなったら新品と交換する。
- ・エアフィルター 1年に1回、新品と交換する。
- ・バッテリー 交換時期を示すコメントが表示されたときに交換する。

【包装】 1台

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：サクラ精機株式会社
住 所：長野県千曲市大字八幡1122-8
電話番号：026-272-8381

製 造 元：サクラ精機株式会社
住 所：長野県千曲市大字鋳物師屋75-5
電話番号：026-272-2381

取扱説明書を必ずご参照ください。